neodisher® MediClean forte

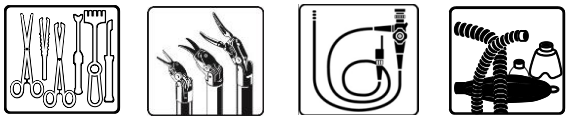

Mazgāšanas līdzeklis termostabilu un termolabilu instrumentu apstrādei

Šķidrs koncentrāts

Lietošanas joma:

- Termostabilu un termolabilu instrumentu, tostarp *MIC* un mikroinstrumentu, elastīgo endoskopu, anestēzijas piederumu, konteineru un citu medicīnisko piederumu mehāniska mazgāšana
- Termostabilu un termolabilu instrumentu manuāla mazgāšana mērcēšanas un ultraskaņas vannā
- Piemērots arī *da Vinci EndoWrist* instrumentu manuālai un mehāniskai mazgāšanai
- Individuālais aizsardzības līdzekļu manuāla un mehāniska mazgāšana[1]

Iedarbība:

- Nevainojami notīra piekaltušu un denaturētu asiņu atliekas
- Pamatīgi noārda organiskos materiālus un nepieļauj olbaltumvielu atlieku atkārtotu piesaistīšanu
- Atbilst jaunākajiem Roberta Koha institūta (RKI) ieteikumiem attiecībā uz medicīnisko ierīču apstrādi nolūka mazināt jauna Kreicfelda-Jakoba slimības (*vCJK*) varianta pārnešanas risku
- Notīra dažādu prionu testa celmu, tostarp arī *vCJK* testa celma, patogēnos prionu proteīnus par > 2 lg pakāpēm (1 %, 55 °C, 10 min)[2]
- Palīdz notīrīt bioplēves atliekas
- Piemērots nerūsējošā tērauda, instrumentu tērauda, optikas, parasto plastmasu un anestēzijas piederumu materiālu instrumentiem
- Anodēta alumīnija piemērotība iepriekš ir jāpārbauda

Specifiskās īpašības:

- Īpaši saudzējošs dažādiem materiāliem
- Pirmklasīga mazgāšanas veiktspēja, ko nodrošina unikāla formula, kuras pamatā ir sārmainības izraisītāji, virsmaktīvās vielas un enzīmi
- Izmantojot manuālai priekšmazgāšanai, pirms nākamā mehāniskā mazgāšanas posma ar neodisher MediClean forte mazgāšanas līdzeklis nav jānoskalo
- Mehāniskai apstrādei neitralizēšanas posms nav nepieciešamas, tāpēc īsāks programmas izpildes laiks
- Nav klasificēts kā bīstama viela, bīstama prece

Lietošana un dozēšana:

Līdzekli neodisher MediClean forte var izmantot mazgāšanas un dezinfekcijas ierīcēs, kā arī mērcēšanas un ultraskaņas vannās. Dozu nosaka, cita starpā ņemot vērā instrumentu pielietojuma jomu un piesārņojuma pakāpi. Apstrādājot *da Vinci EndoWrist* instrumentus, neodisher MediClean forte var izmantot visos manuālas priekšmazgāšanas posmos, apstrādē ar ultraskaņu un mehāniskajā apstrādes procesā.

Mazgājot individuālais aizsardzības līdzekļus[1] mērcēšanas vannā, visā mērcēšanas ciklā tie ir pilnībā jāiemērc mazgāšanas šķīdumā. Pēc tam tie rūpīgi jānoskalo tekošā ūdenī, kas atbilst vismaz dzeramā ūdens kvalitātei.

Lietojot neodisher MediClean forte, ieteicams ievērot šādus parametrus:

neodisher® MediClean forte

Instrumentu mehāniska un manuāla mazgāšana:

Termostabilu un termolabilu instrumentu mehāniska mazgāšana Standarta ieteikums	2–10 ml/l (0,2–1,0 %)*, piem., 40–60 °C, 10 min 5 ml/l (0,5 %)*, piem., 55 °C, 10 min
Elastīgo endoskopu un endoskopijas piederumu mehāniska mazgāšana	5 ml/l (0,5 %), 35–55°C, 5 min
da Vinci EndoWrist instrumentu mehāniska mazgāšana	8 ml/l (0,8 %), 40–55°C, 10–30 min**
Termostabilu un termolabilu instrumentu manuāla mazgāšana mērcēšanas un ultraskaņas vannā	5–20 ml/l (0,5–2 %)*, maks. 40 °C, 10–30 min
Elastīgo endoskopu un endoskopijas piederumu manuāla mazgāšana mērcēšanas un ultraskaņas vannā	5–30 ml/l (0,5–3 %)*, maks. 40 °C, 5–10 min
da Vinci EndoWrist instrumentu manuāla mazgāšana mērcēšanas un ultraskaņas vannā	10 ml/l (1,0 %), maks. 40 °C

Individuālais aizsardzības līdzekļu manuāla un mehāniska mazgāšana[1]:

Respiratoru un piederumu manuāla mazgāšana mērcēšanas vannā	10 ml/l–30 ml/l (1,0 %–3,0 %)*, Aukstā ūdenī līdz maks. 40 °C, 15–30 min
Atsevišķu individuālās aizsardzības līdzekļu[1] (atļauts saskaņā ar ražotāja norādījumiem), respiratoru un piederumu mehāniska mazgāšana mazgāšanas un dezinfekcijas ierīcēs un/vai veļas mazgājamās mašīnās (speciālās programmas saskaņā ar ražotāja norādījumiem)	10 ml/l (1 %), 55 °C, 2 min

* doza cita starpā atkarīga no piesārņojuma pakāpes

** atbilstoši attiecīgajiem mazgāšanas un dezinfekcijas ierīces ražotāja ieteikumiem

Dozēšanai jāizmanto piemērotas dozēšanas ierīces.

Mazgāšanas posmā un noslēdzošajā skalošanas posmā ieteicams izmantot demineralizētu ūdeni. Demineralizēta ūdens izmantošana noslēdzošajā skalošanas posmā novērš ūdens traipu veidošanos un vienlaikus aizsargā anodētu alumīniju.

Klasiskajiem sārmainajiem mazgāšanas līdzekļiem nepieciešamo neitralizācijas posmu var neveikt. Apstrādājot acu instrumentus, pirms noslēdzošās skalošanas ieteicams iekļaut papildu starpskalošanas posmu.

Manuālās mazgāšanas procesā lietojamo šķīdumu vēlams sagatavot katrā darba dienā no jauna, un redzama piesārņojuma gadījumā tas jānomaina.

Vispārīgi norādījumi par lietošanu:

- Paredzēts tikai profesionālai lietošanai
- Nejaukt kopā ar citiem mazgāšanas līdzekļiem.
- Pirms mazgāšanas līdzekļa nomaiņas dozēšanas sistēma un iesūkšanas šļūtenes jāizskalo ar ūdeni.
- Apstrāde jāveic atbilstoši medicīnisko ierīču tiesību aktiem un piemērojamiem noteikumiem, izmantojot piemērotas validētas procedūras.
- Līdzekļa neodisher MediClean forte mazgāšanas šķīdums ir pilnībā jānoskalo ar ūdeni (vēlams demineralizētu).
- Medicīnisko ierīču apstrāde: Ievērojiet medicīniskās ierīces ražotāja ieteikumus attiecībā uz apstrādi saskaņā ar standarta DIN EN ISO 17664 prasībām.
- Individuālo aizsardzības līdzekļu apstrāde[1]: Ievērojiet individuālo aizsardzības līdzekļu ražotāja ieteikumus attiecībā uz apstrādi
- Jāievēro mazgāšanas un dezinfekcijas ierīces ražotāja lietošanas instrukcijas

neodisher® MediClean forte

Sertifikāts:

Pēc pieprasījuma labprāt izsniegsim *da Vinci Endowrist* instrumentu apstrādes procedūras sertifikātu.

Saistībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu tirdzniecības atļaujas piešķiršanu[1] dažādas pārbaudes un atļauju piešķiršanas iestādes pārbaudīja neodisher MediClean forte attiecībā uz saderību ar dažādiem materiāliem un novērtēja to pozitīvi.

Tehniskie dati:

pH līmenis	10,4–10,8 (2–10 ml/l, noteikts demineralizētā ūdenī, 20 °C), pilsētas ūdenī vai mīkstinātā ūdenī, kā arī, piemēram, iekļuvušā priekšmazgāšanas ūdens dēļ pH līmenis var atšķirties.
Blīvums	apt. 1,1 g/cm^3 (20 °C)
Viskozitāte	< 10 mPa s (koncentrāts, 20 °C)
Titrēšanas koeficients	0,77 (saskaņā ar neodisher MediClean forte titrēšanas instrukciju)

Sastāvs:

Mazgāšanas līdzekļa sastāvs atbilstoši Regulai (EK) Nr. 648/2004:
< 5 % nejonu un anjonu virsmaktīvās vielas
turklāt: enzīmi

CE zīme: CE MD

neodisher MediClean forte atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas medicīnisko ierīču tiesību aktos.

Ja saistībā ar šo produktu rodas smags negadījums, par to jāziņo ražotājam un atbildīgajai iestādei.

Uzglabāšana:

vēsā vietā, sargāt no sasalšanas. Jāuzglabā 0 °C–25 °C temperatūrā. Sargāt no saules staru iedarbības. Noteikumiem atbilstošos apstākļos var uzglabāt 2 gadus. Izlietot līdz: skat. uzrakstu uz etiķetes pēc simbola ⌛.

Uzglabāšanas laikā noslēgtās sākotnējā iepakojuma kannās var rasties krāsas izmaiņas. Tas neietekmē lietošanas tehniskās īpašības.

Norādes par bīstamību un drošību:

neodisher MediClean forte nav bīstama viela *CLP* regulas (EK) Nr. 1272/2008 nozīmē.

Izmetiet tikai iztukšotu un aizvērtu kannu. Informāciju par līdzekļa atlieku iznīcināšanu skatiet drošības datu lapā.

Papildu informāciju par drošību un vidi skatiet drošības datu lapās. Tās pieejamas vietnē www.drweigert.de, sadaļā “Service/Downloads”.

---

[1] Individuālās aizsardzības līdzekļi, apģērbs aizsardzībai pret ķīmiskām vielām, tostarp niršanas aprīkojums (IAL)

[2] Evaluation of the ability of neodisher MediClean forte to inactivate and /or remove transmissible spongiform encephalopathy (TSE, Prions) agents from surfaces of medical and surgical devices, after direct inoculation of experimentally contaminated surfaces - Service d’Etude des Prions et des Infections Atypiques

MB 4050/03-4
Redakcija 05/2022

Šajā instrukcijā sniegtā informācija ir sagatavota, pamatojoties uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi. Tomēr lietotājam pašam ir jāveic savas pārbaudes un izmēģinājumi.
No šīs informācijas nevar atvasināt juridiski saistošas garantijas attiecībā uz konkrētām īpašībām.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.com